


MARCA

**ChannelMED®**

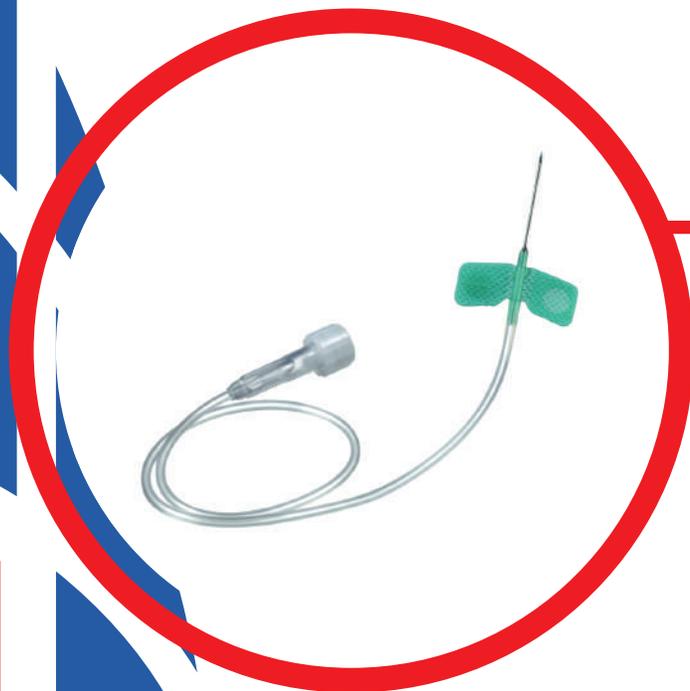

## FICHA TÉCNICA

### AGUJA EPICRANEAL (ALITAS)

- N° 19G
- N° 20G
- N° 21G
- N° 22G
- N° 23G
- N° 25G

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aguja estéril con aletas para inyección, infusión y transfusión (Triple afilado)
- De un solo uso con aletas flexibles pvc (No tóxico) antideslizantes y ergonómicas
- Identificación por colores para la rápida identificación de tamaño de la aguja
- Tubo pvc no tóxico transparente de volumen controlado Esterilizado en óxido de etileno
- Para conexión luer lock (Rosca)



**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

**PAÍS DE  
PROCEDENCIA**



REGISTRO  
SANITARIO

DI - 47684/2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2023



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

**ChannelMED®**



## FICHA TÉCNICA

### BAJA LENGUAS DE MADERA ADULTO

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Madera de superficie suave, uniforme, lisa, sin astillas, de bordes redondeados
- De peso ligero y resistente a la manipulación
- Desechable, hipoalergénico, sin olor, sin contaminantes
- No tóxico y libre de pirógenos
- No estéril de un solo uso
- Caja x 100 Piezas



**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

## PAÍS DE PROCEDENCIA



REGISTRO  
SANITARIO

DI - 47684/2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2023



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

**ChannelMED®**



## FICHA TÉCNICA

### BOLSA DE ORINA 2 LT. CON VÁLVULA

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Retorno de la orina a través del tubo
- Capacidad de 2000 ml
- Bolsa con escala medidora de 100 ml de fácil visibilidad y hendiduras reforzadas en los extremos superiores permitiendo un acoplamiento de un gancho de soporte
- Tubo de entrada de plástico pvc flexible transparente y anticodable
- Con conector universal de punta acanalada, con un capuchón para proteger el conector
- El sistema evacuador al final de la bolsa presenta un tapón de polietileno de color azul, deslizable para cierre y apertura de la válvula de vaciado
- Esterilizado con EO (gas óxido de etileno o eto)



**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

**PAÍS DE  
PROCEDENCIA**



REGISTRO  
SANITARIO

DI - 47684/2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2023




**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

**ChannelMED®**

## FICHA TÉCNICA

### CEPILLO PARA CITOLOGÍA

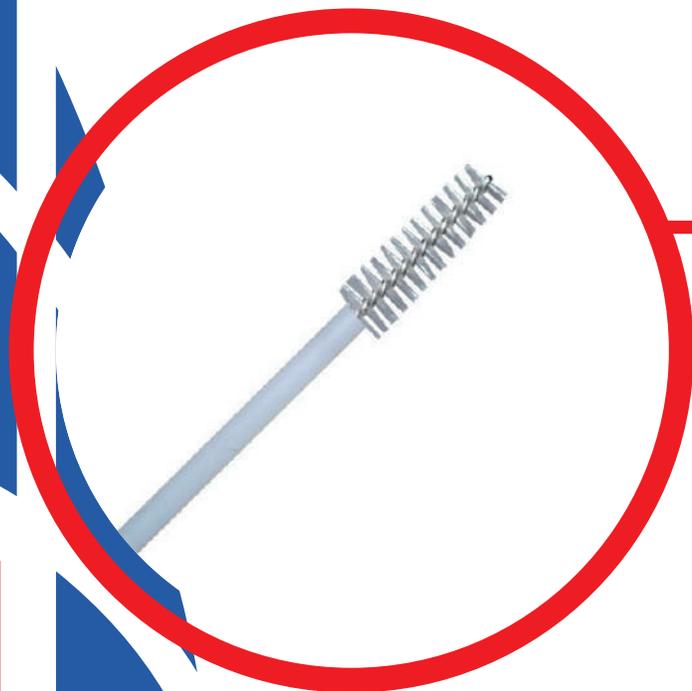

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cepillo citológico para recogida de muestras del canal endocervical.
- Envase individual estéril por óxido de etileno.
- Consta de una parte central cilíndrica de plástico, a la cual va unida un escobillón de nylon enrollado sobre un alambre de acero inoxidable
- Medida de largo 19 cm.
- Cerdas extra suaves minimizando posibles laceraciones
- Caja x 100 Piezas.



**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

## PAÍS DE PROCEDENCIA




DI - 50653/2019 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2019  
(IMPORTADORA TAMIVA ADJUNTA FORMULARIO 027  
DOCUMENTO DE RESPALDO EN TRÁMITE DE REINSCRIPCIÓN)



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

**ChannelMED®**

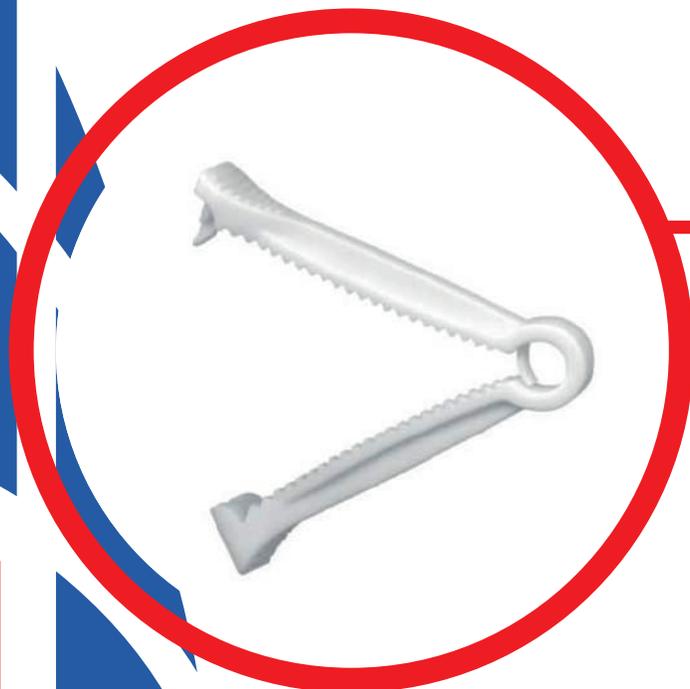

## FICHA TÉCNICA

### CLAMP UMBILICAL

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Clamp de polietileno (PE)
- Atóxico e hipoalergénico.
- Con broche de seguridad de cierre hermético seguro.
- Esterilizado por óxido de etileno (ETO)
- Empaque individual que garantiza la esterilidad del producto, con pell open que proporciona una apertura uniforme



**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

**PAÍS DE  
PROCEDENCIA**



REGISTRO  
SANITARIO

DI - 48091/2023 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2023



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

**ChannelMED®**



## FICHA TÉCNICA

### COLECTOR DE ORINA PEDIÁTRICO 100 ml. (Unisex)

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Bolsa de plástico transparente fabricado a base de polietileno (PE) de grado médico
- Capacidad de 100 ml
- La bolsa tiene impreso una escala de graduación de 10 ml. a 100 ml.
- Presentación con una abertura ovalada cubierta por una cinta adhesiva hipoalergénico y atraumática
- Posee una almohadilla interna para proteger la piel
- Superficie lisa y flexible
- No contiene látex
- Atóxico, no pirógeno
- Estéril por óxido de etileno



**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

## PAÍS DE PROCEDENCIA



REGISTRO  
SANITARIO

DI - 47683/2023 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

**ChannelMED®**



## FICHA TÉCNICA

### EQUIPO DE SUERO CON CONECTOR EN "Y"

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tubo de pvc resistente y flexible
- Cámara de goteo flexible, transparente y clara
- Punto de inyección en "Y" con membrana de látex para el suministro de medicamentos
- Presión de goteo: 20 gotas: 1ml  $\pm$  0.1 (1g $\pm$ 0.1g)
- Controlador de flujo o goteo (Rollers)
- No tóxico
- No pirógeno
- Con aguja nº 21 G. 1 1/2
- Sonda flexible de 150 cm.
- Estéril por óxido de etileno



**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

## PAÍS DE PROCEDENCIA



REGISTRO  
SANITARIO

DI - 50649/2024 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

**ChannelMED®**



## FICHA TÉCNICA

**MICROGOTERO  
CON BURETA  
(100 ml. - 150 ml.)**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tubo pvc con escala graduada transparente.
- Sonda flexible de 150 cm aprox.
- Controlador de flujo tipo rodillo
- Con dispositivo de aire con filtro que permite la filtración de microorganismos en rango de 2.5 a 5 micras.
- Precisión de goteo: 60 gotas/ml
- Punto de inyección en "Y" auto cicatrizante.
- Conexión luer lock (Rosca) - sin aguja
- Clamp de apertura
- Libre de pirógenos y de ácidos.
- Estéril por óxido de etileno



**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

**PAÍS DE  
PROCEDENCIA**



REGISTRO  
SANITARIO


DI - 50649/2024 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

**ChannelMED®**

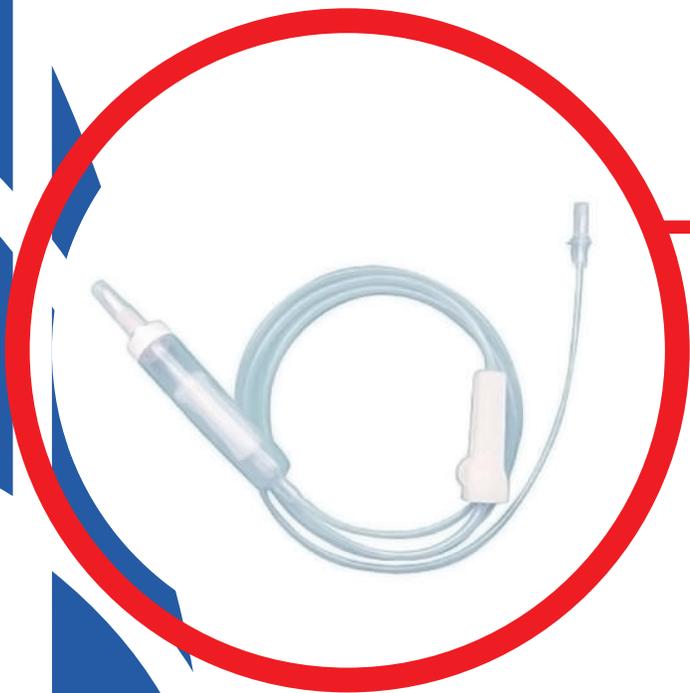

## FICHA TÉCNICA

### EQUIPO DE TRANSFUSIÓN

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cámara de goteo flexible, tiene un filtro de nylon que presenta una abertura de malla para coágulos y bacterias.
- La manguera está hecha de pvc.
- Tiene una abrazadera de rodillo compuesto de polietileno.
- Sonda flexible de 150 cm.
- Con aguja 18g.
- Empaque individual, que garantiza la integridad y esterilidad del producto
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y/o aristas cortantes
- Estéril por óxido de etileno



**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

## PAÍS DE PROCEDENCIA



REGISTRO  
SANITARIO


DI - 50649/2024 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

**ChannelMED®**

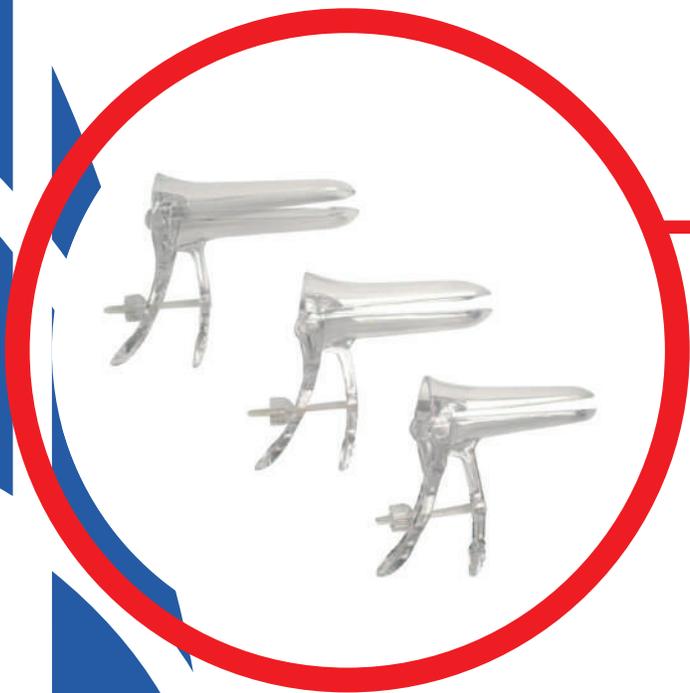

## FICHA TÉCNICA

### ESPÉCULO VAGINAL DESECHABLE ESTÉRIL (Pequeño - Mediano - Grande)

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Espéculo vaginal descartable.
- Material polietileno.
- Esterilizado con gas de óxido de etileno.
- Empaque individual espéculo vaginal descartable.
- Material polietileno.
- Esterilizado con gas de óxido de etileno
- Empaque individual



**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

**PAÍS DE  
PROCEDENCIA**



REGISTRO  
SANITARIO


DI - 50655/2024 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

**ChannelMED®**

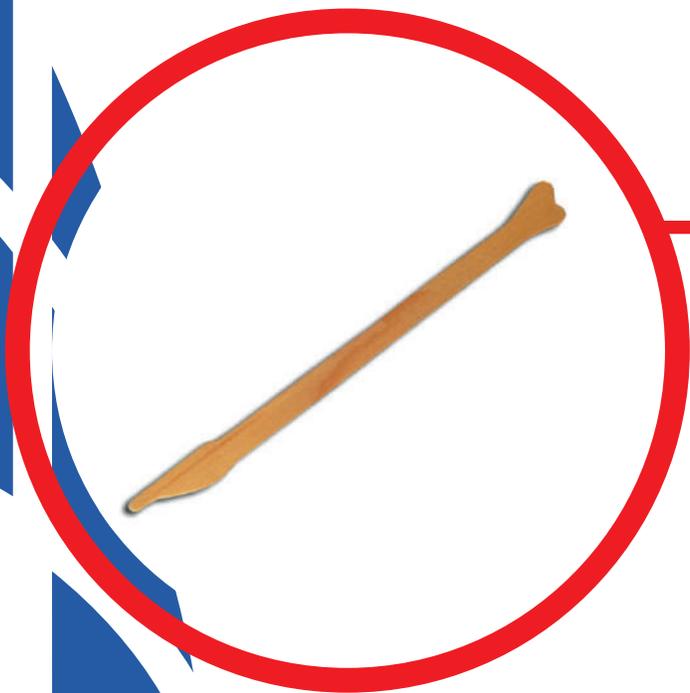

## FICHA TÉCNICA

**ESPÁTULA DE AYRE  
(Cj. X 100 Pzs.)**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Espátula de ayre para muestreo en exploraciones ginecológicas
- De madera, de un solo uso
- Sin astillas
- Son atraumáticas
- No estéril



**PAÍS DE  
PROCEDENCIA**

**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.



REGISTRO  
SANITARIO

DI - 50653/2019 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2019  
(IMPORTADORA TAMIVA ADJUNTA FORMULARIO 027  
DOCUMENTO DE RESPALDO EN TRÁMITE DE REINSCRIPCIÓN)



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

**ChannelMED®**



## FICHA TÉCNICA

### GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES

Nº 6½

Nº 7

Nº 7½

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Guante quirúrgico de látex natural con componentes hipoalérgicos.
- Descartables y de fácil apertura.
- Preacondicionado con polvo bioabsorbible.
- Anatómicos
- Con un acabado antideslizante en palma y dedos.
- Esterilizado mediante rayos gamma.
- Un par por cada empaque - izquierda / derecha ajustada para mayor comodidad
- Alta resistencia y elasticidad.



**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

## PAÍS DE PROCEDENCIA



REGISTRO  
SANITARIO

DI - 46762/2020 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2020



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

**ChannelMED®**



## FICHA TÉCNICA

### HOJA DE BISTURÍ

Nº 10  
Nº 11  
Nº 12  
Nº 15  
Nº 20  
Nº 21  
Nº 22  
Nº 23  
Nº 24

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricada en material acero inoxidable de uso médico.
- Con bordes afilados por las dos caras.
- Con ranura para incorporar el mango de bisturí estándar.
- Descartables (de un solo uso).
- Empaque individual en sobre de aluminio de fácil apertura.
- Rótulo del número de hoja y la fecha de expiración en cada empaque.
- Esterilizado en rayos gamma.
- Caja x 100 Piezas



**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

## PAÍS DE PROCEDENCIA



REGISTRO  
SANITARIO

DI - 50652/2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

**ChannelMED®**



## **FICHA TÉCNICA**

### **HISOPOS ESTÉRILES**

#### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Hisopo estéril de seis pulgadas.
- Mango de madera de material consistente.
- Torunda de algodón firmemente adherida a uno de los extremos de mango de madera.
- Largo del hisopo 15 cm. Aproximado.
- Estéril con envoltura individual.
- Estéril por óxido de etileno.
- Caja x 100 Piezas.



**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

## **PAÍS DE**

### **PROCEDENCIA**



REGISTRO  
SANITARIO

DI - 57934/2021 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2021



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

**ChannelMED®**



## FICHA TÉCNICA

### HISOPOS NO ESTÉRILES

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Hisopo no estéril de seis pulgadas.
- Mango de madera de material consistente.
- Torunda de algodón firmemente adherida a uno de los extremos de mango de madera.
- Largo del hisopo 15 cm. Aproximado.
- Paquete x 100 Piezas.



**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

**PAÍS DE  
PROCEDENCIA**



REGISTRO  
SANITARIO

DI - 57934/2021 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2021



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

**ChannelMED®**

## FICHA TÉCNICA

### LANCETAS



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Es utilizada para extraer pequeña cantidad de sangre.
- Fabricado a base de acero inoxidable.
- Lancetas de punto capilar.
- Esterilizado en rayos gamma.
- Desechables.
- Punta fina que facilita su uso y disminuye el dolor.
- Caja x 100 Piezas



**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

**PAÍS DE  
PROCEDENCIA**



REGISTRO  
SANITARIO

DI - 52738/2020 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2020



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

**ChannelMED®**



## FICHA TÉCNICA

**MASCARILLA  
3 PLIEGOS C/ELÁSTICO  
BLANCO - CELESTE**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Mascarilla rectangular
- Con elástico de mayor resistencia.
- Diseño con 3 pliegues
- Hipoalergénica.
- Protección respiratoria
- Clip nasal ajustable para mayor comodidad y protección.
- Filtro antibacterial
- Caja x 50 Piezas



**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

**PAÍS DE  
PROCEDENCIA**



REGISTRO  
SANITARIO

DI - 46838/2023 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

**ChannelMED®**



## FICHA TÉCNICA

**PULSERA DE  
IDENTIFICACION  
INFANTIL  
(Rosa - Celeste - Blanco)**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Confeccionadas en vinilo suave
- Broche securesnap patentado de cierre que proporciona máxima seguridad.
- Tarjetas de inserto incluidas con reglones para escritura.
- Colores blanco - rosado - celeste
- Libre de látex



**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

**PAÍS DE  
PROCEDENCIA**



REGISTRO  
SANITARIO

DI - 57934/2021 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2021



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS


MARCA \_\_\_\_\_

**ChannelMED®**

## FICHA TÉCNICA

### SONDA DE ASPIRACIÓN CON VÁLVULA

Nº 4  
Nº 6  
Nº 8  
Nº 10  
Nº 12  
Nº 14  
Nº 16  
Nº 18

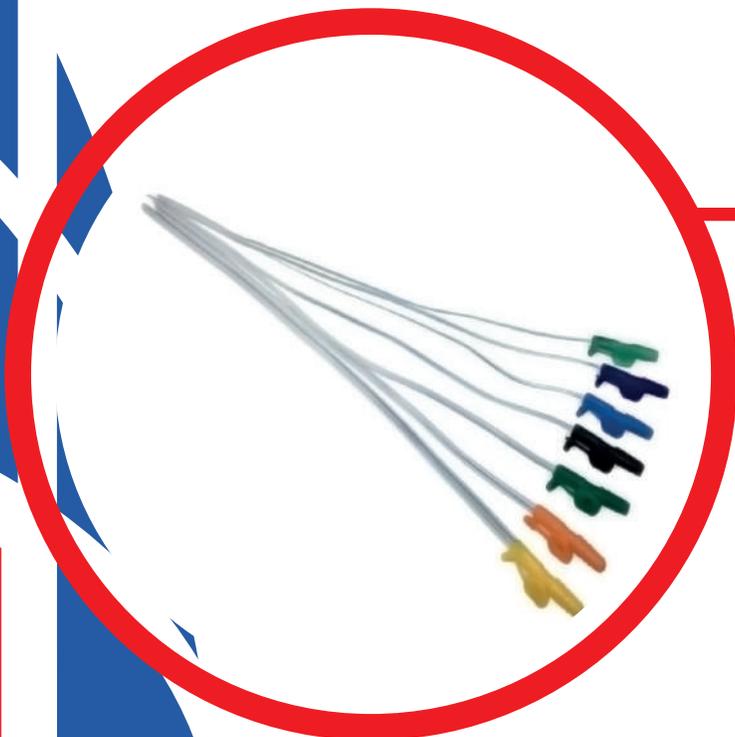

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Sonda de pvc (Cloruro de polivinilo) grado médico.
- Tubo de succión transparente, flexible, uniforme y de fácil manejo.
- Con un extremo distal abierto, con dos orificios laterales.
- Con válvula de control manual que permite una succión intermitente con mínimo riesgo de contaminación.
- Presenta un conector de fácil manejo con identificación de colores por calibre
- Presenta una longitud de 45 cm. a 50 cm.
- Empaque individual, bolsa plástica de polietileno (PE)
- No tóxico, no pirógeno
- Esterilizado con EO (Gas óxido de etileno o eto)



**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

## PAÍS DE PROCEDENCIA



REGISTRO  
SANITARIO

DI - 48090/2023 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA \_\_\_\_\_

**ChannelMED®**



## FICHA TÉCNICA

### SONDA NASOGÁSTRICA

Nº 4  
Nº 6  
Nº 8  
Nº 10  
Nº 12  
Nº 14  
Nº 16  
Nº 18

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Sonda de pvc grado médico.
- Punta ovalada para evitar trauma.
- Extremo distal con 2 orificios laterales y uno en su punta.
- Líneas de indicación de distancia de la punta de la sonda.
- Sonda con seguro de escape, para después de la alimentación.
- Producto de un solo uso.
- Esterilizado con EO (Gas óxido de etileno o ETO).
- No tóxico, libre de pirógenos.



### PAÍS DE PROCEDENCIA

**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.



REGISTRO  
SANITARIO

DI-52871/2020 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2020



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA \_\_\_\_\_

**ChannelMED®**



## FICHA TÉCNICA

**TELA ADHESIVA  
IMPERMEABLE  
5 cm X 4.5 m.  
10 cm X 4.5 m.**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Adhesivo con óxido de zinc evita irritaciones.
- Flexible, ligera, hipoalergenico, impermeable, resistente a las temperatura extremas, microporoso y altamente transpirable.
- Permite la permeabilidad del aire y el vapor de agua.
- No contiene látex ni derivados.
- No estéril, de un solo uso.



**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

**PAÍS DE  
PROCEDENCIA**



REGISTRO  
SANITARIO

DI - 47684/2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2023



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

**ChannelMED®**



## FICHA TÉCNICA

### VENDA ELÁSTICA

**7.5 cm X 4.5 m.**

**10 cm X 4.5 m.**

**15 cm X 4.5 m.**

**20 cm X 4.5 m.**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Venda elástica de tejido plano de algodón con fibras elásticas sintéticas.
- Resistente con alto porcentaje de extensión.
- Incluye 2 broches metálicos de sujeción.
- Flexible, libre de impurezas y partículas extrañas, suaves al tacto Hipoalergénico.
- No estéril.
- Venda color piel.
- Bolsa individual sellada que garantiza la integridad del producto



**CHINA**

SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

## PAÍS DE

## PROCEDENCIA



REGISTRO  
SANITARIO

DI - 47684/2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2023



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS